

SERIE 200

# CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 250 CF



  
GROUPE UTAC CERAM

**CONFORME À LA NORME NF EN 1865**

TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789  
§ 4.5.9 : P.V. N°15/10151

## CARACTERISTIQUES

### Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 5 parties (appui-tête, dossier, assise, jambes et pieds) réglage par vérins à blocage hydraulique à commande déportée ou bilatérale (système breveté)
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- 1 barrière de pieds
- 1 matelas grand confort 5 parties forme baquet bicolore dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, Rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10g
- 2 béquilles repliables à dépliage automatique assisté par vérins
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 50 cm
- Charge maximum conseillée : 160 kg (Testé à 250 kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

### Options d'usine

- Couleur spécifique
- Couche amovible
- Déplacement de la manette de commande de vérin derrière la tête
- Barrière de pieds renforcée
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 9 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Double commande de vérin de dossier
- Positions intermédiaires sur béquille arrière sur demande

### Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 275
- Hauteur déplié : 775

### Poids

- 36 kg (brancard + matelas + barrières + systèmes d'attache)

### Normes

Conforme à la norme  
NF EN 1865

Testé et validé par  UTAC CERAM

selon la norme NF EN 1789  
§ 4.5.9 : P.V. n°15/10151




### Accessoires disponibles


- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Tablette support cardio 3 appuis, repliable avec supports avant indépendants pour transfert latéral du patient
- Support spéciaux de tablette cardio (3 appuis) pour couche articulée
- Porte-bouteille Ø2 1m3 (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Caisson de rangement sur série 200, couche fixe, sous le dossier uniquement
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10g



**Vue des différentes positions d'utilisation :**

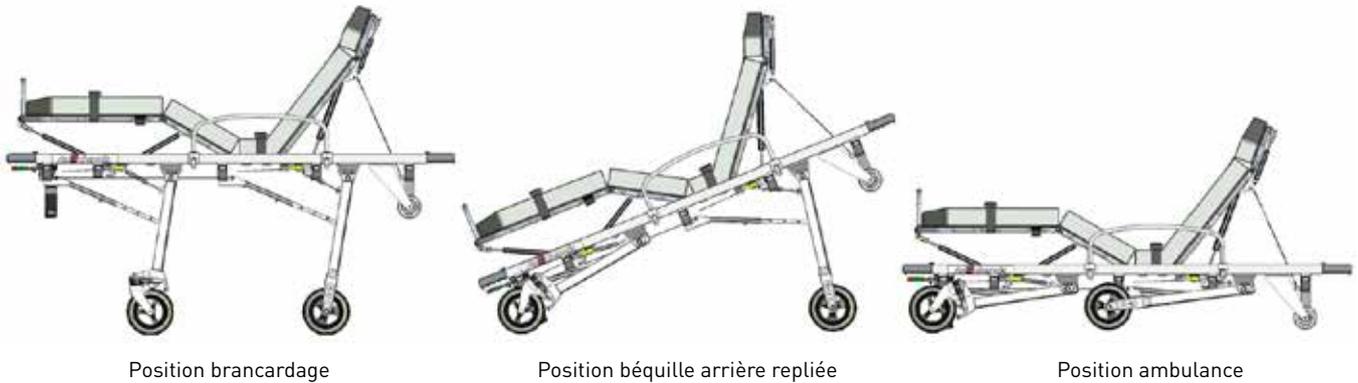

**Vue des différentes positions intermédiaires (sur demande) :**

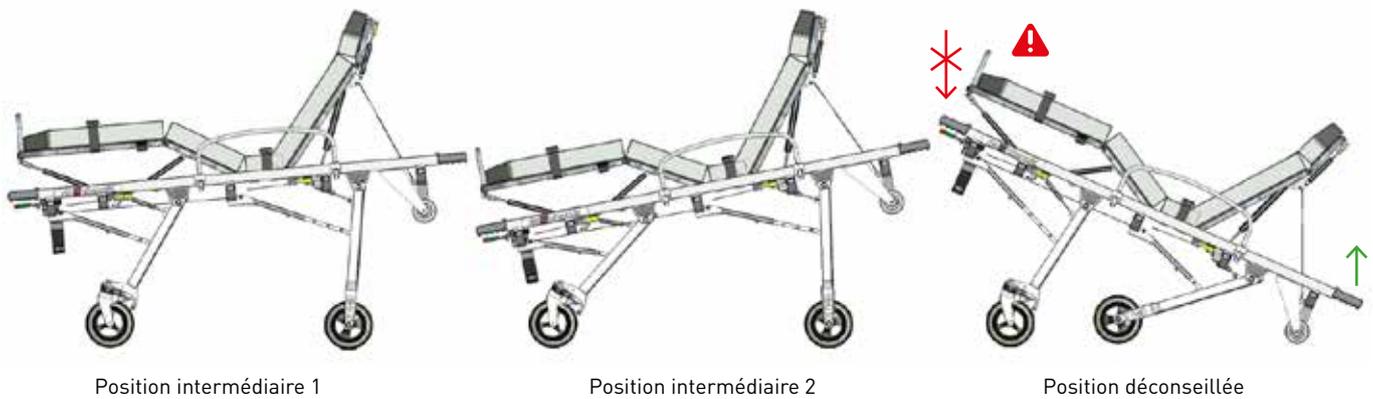

**Plan du brancard**

